


Statistikk prøvetakingskurs

Suspendert stoff på innløpsprøve

RA / Dato	Operatør	Verdi	% avvik fra middel	Z-verdi	Godkjent
Rambekk					
08.mar.11	SEH	212	-5	-0,6	☺
	SEH	200	-11	-1,3	☺
	SEH	204	-9	-1,1	☺
	SEH	212	-5	-0,6	☺
	SEH	234	4	0,5	☺
	SEH	212	-5	-0,6	☺
	TS	216	-4	-0,4	☺
	TS	230	3	0,3	☺
	TL	228	2	0,2	☺
	TL	256	14	1,7	☺
	GAN	210	-6	-0,7	☺
	GAN	238	6	0,7	☺
	TAA	210	-6	-0,7	☺
	TAA	218	-3	-0,3	☺
	KB	266	19	2,2	☹
	KB	254	13	1,6	☺
	SEH	226	1	0,1	☺
	SEH	210	-6	-0,7	☺
Middel		224			
Sd		19			

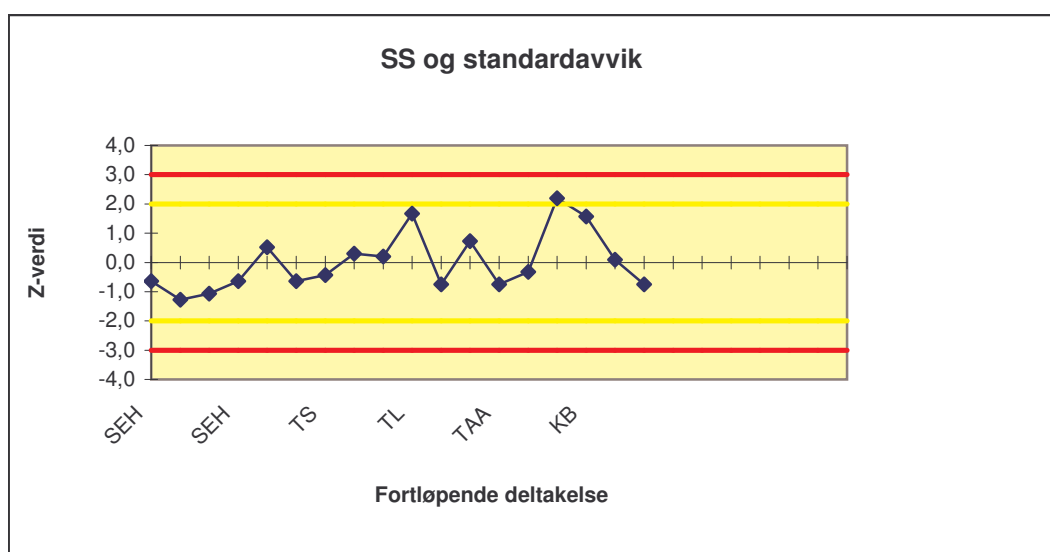

Pr. mars -11

CV

Generelt

6,78 %

Riktig måleusikkerhet = $\pm 2 \cdot CV$

13,56 %